





実験日時：1/18 1/19 1/20

●アセトニトリルガス分光@20Pa（時定数比較）

	ステップ周波数	計測回数	時定数
左上	30kHz	16667	100ms
右上	500kHz	1000	1s
左下	5MHz	20000	100ms
右下	12.5MHz	8000	1s





時定数：100ms



時定数：1s

●パイロ DR・SNR (100ms)

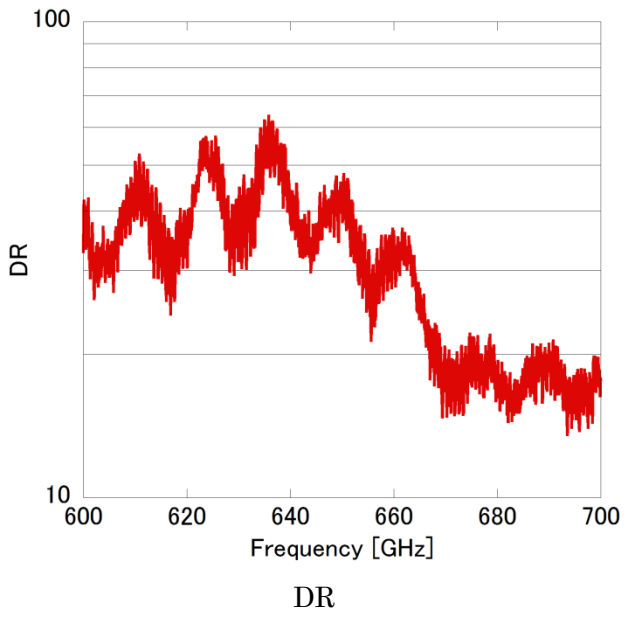

今後の予定

●ゴーレイセル導入